# 新型コロナウイルス抗体検査キット

現在新型コロナウイルス感染の検査に用いられている PCR 法の遺伝子検査と比べて、時間、コスト、作業スペースの削減など検査の大幅な効率化が可能な検査キットです。

・新型コロナウイルス抗体（IgM）と（IgG）2 抗体別々の**検査コストの約半分**

・実績：EU・USA 医療機関／中国全土指定医療機関　使用

## 所要時間約 10 分の簡単、迅速検査

血液中の新型コロナウイルス（IgM,IgG )2 抗体を同時に迅速に検出します。
操作は①用意②採血③測定の簡単 3 ステップ。結果はラインの有無を目視で確認できるので誰でも簡単に検査が可能です。

## 検査実績

IgM 抗体検出用キットと IgG 抗体検出用キットを合わせて約 1,000,000 の検査実績により、検査精度の高さが確認されています。

## 必要な試薬は全てキットに同梱　※注意・使用方法（日本語）はこの用紙の裏面をご覧ください。

検査に必要なものは全てキットに含まれており、すぐに検査を実施可能です。

| | |
|---|---|
| ・検出カード | 1 本 |
| ・使い捨てマイクロピペット | 1 本 |
| ・検査液 | 1 本 |
| ・アルコール Pad（消毒用） | 2 枚 |
| ・採血針（ランセット） | 1 個 |
| ・詳細説明書（英語版） | 1 枚 |

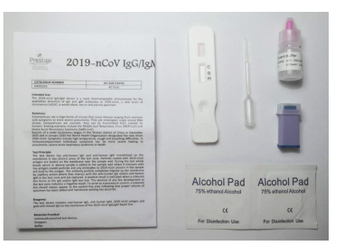


## 注意事項（免責）必ずお読みください。

### ＜検査について＞

本検査キットの検出カードが表示する結果は陽性・陰性のみで、COVID-19 への感染状況を 100% 確定するものではありません。確定には検査機関が行っている PCR 検査などの、他の検査の実施が必要であり、医療機関や医師の診断結果を優先してください。
そのため、検査に対するお問い合わせ対応業務は行っておりません。

### ＜返品・交換について＞

本検査キットは商品の特性上「返品不可」商品です。検査を失敗した場合でも、一切のお客様都合による返品・交換を承りません。検査における手順、注意をよく理解し慎重に行ってください。

### ＜検査試料について＞

本検査キットは、採血針（ランセット）により血液を使用して検査をするキットです。針によるショックや出血によるいかなる事態に対しても当社は一切の責任を負いません。少しでも不安がある方は検査を中止するか、医師の指導のもと検査を行ってください。
採血時は服や周囲に血液が付着しないように注意し、止血は患部をアルコール Pad で押さえ、完全に止血されるまで押さえて確認を行ってください。併せて衛生面も十分にご注意ください。

### ＜貯蔵方法＞

直射日光、高温多湿を避けて 2°C ～ 30°C で保存してください。凍結を避けてください。

精龍堂 https://www.seiryokuzaishop.com

# —— 使用方法 ——

## STEP 1：用意

**1. 開封**
検査キットを開け、内部のパッケージを取り出してください。

検出カード

アルコール Pad（消毒用）

使い捨て
マイクロピペット

検査液

採血針
（ランセット）

## STEP 2：採血

**1. 指先の洗浄**
アルコール Pad（消毒用）で指の腹（採血部位）を洗浄してください。洗浄後十分乾燥させてください。

**2. 血液の採取 -1**
採血針（ランセット）を使用して血液を出します。
※付属の採血針は写真と異なる場合があります。
※採血針を使用するため、不安や抵抗がある方は医師の指導のもと採血を行うか、自己責任で中止してください。

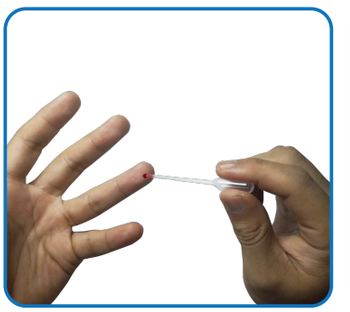

**3. 血液の採取 -2**
スポイトで血液を約 2 滴（0.08cc 程度）採取します。

**4. 指先の洗浄**
アルコール Pad（消毒用）で指の腹（採血部位）を洗浄してください。

## STEP3：測定

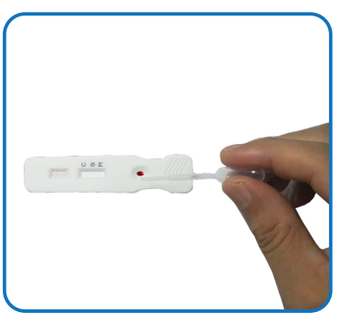

**1. 採取血液を検出カードに滴下**
検出カードの注入部に血液を約 2 滴（0.08cc 程度）滴下します。

**2. 検査液を検出カードに滴下**
検査液 1〜2 滴を検出カードの血液のついた注入部に滴下します。

**3. 検査中**
血液と検査液を投入するとピンクのゾーンが上がっていきます。10〜15 分以内に検査結果が出ます。
※コントロール位置【C】にコントロールラインが出ていることを必ず確認してください。コントロールラインの無い検査結果はいずれも無効です。

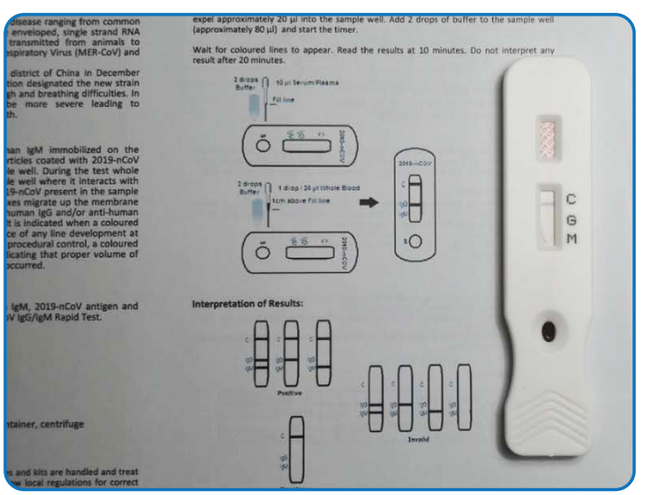


**4. 判定結果**
下の画像に沿って判定結果をご確認ください。


陽性


陰性


無効